

MR I 装置新規更新のお知らせ


MR I 装置新規更新のため、

2026年5月9日（土）～2026年5月26日（火）の間、

MR I 撮影が出来ません。

大変ご迷惑をお掛けします。

5月27日（水）より新しい装置が稼働いたします。

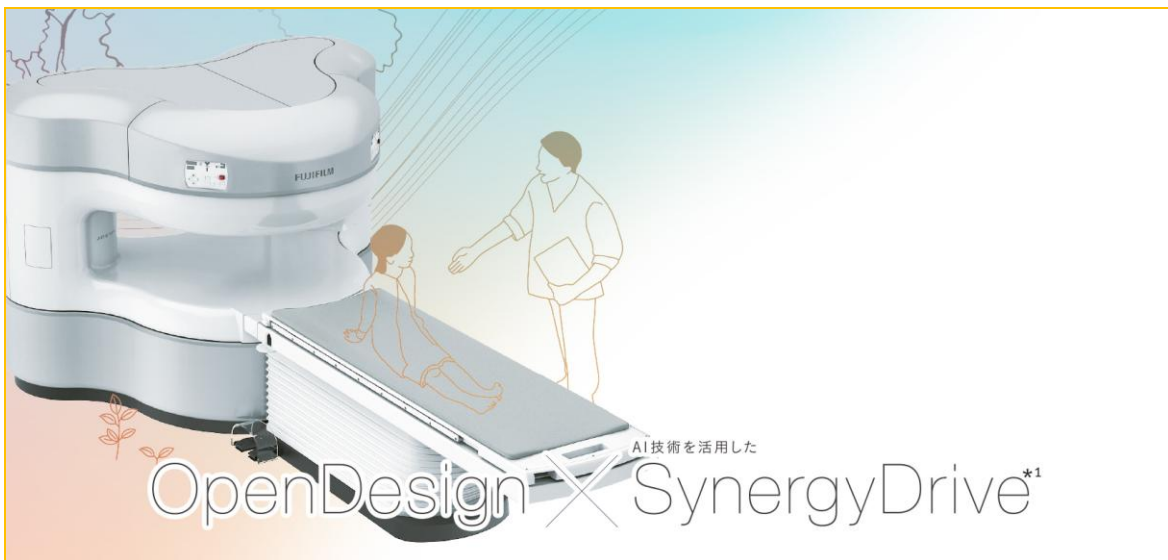

<更新後のMR I 装置>

富士フィルムメディカル製

0.3T オープン型MR I 装置 AIRIS Vento Plus

前機種 of 最新モデルで、静かで解放感のある撮影ができることが特徴です。

寝屋川ひかり病院